



CAMPAGNA SAS SULLE CORRETTE PROCEDURE PER LE INIEZIONI

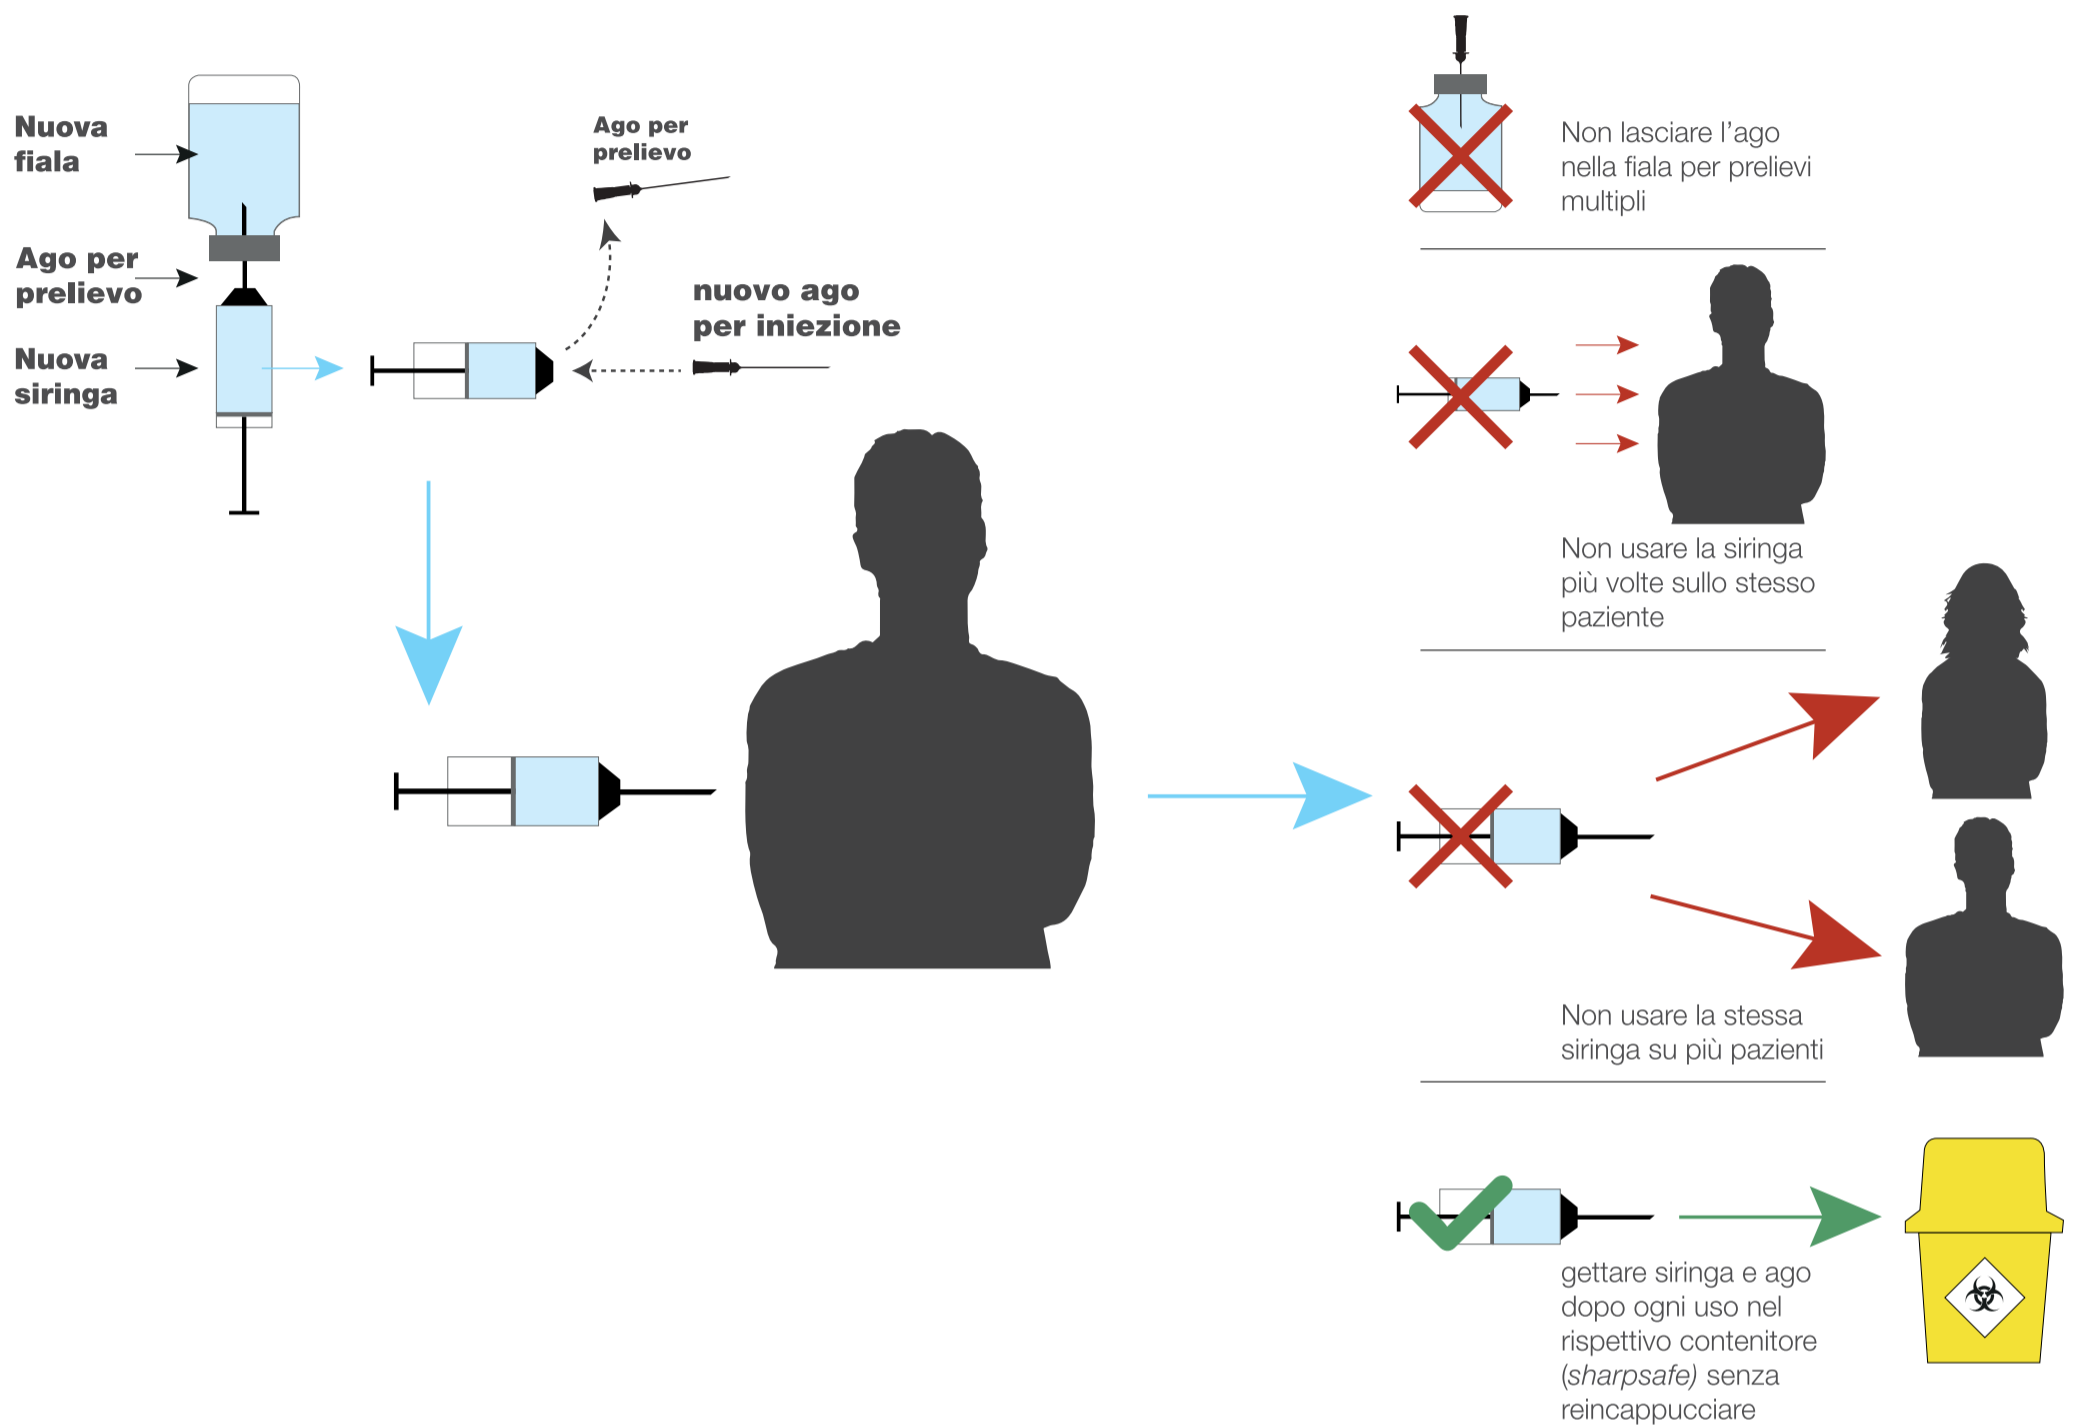


Manipolare il materiale di infusione/iniezione con tecniche asettiche rispettando le precauzioni standard di prevenzione delle infezioni per non contaminare il materiale sterile



Siringhe, aghi e cannule sono dispositivi medici sterili e monouso. Dopo il primo uso, non devono essere riutilizzati:

- ✗ su di un altro paziente
- ✗ due o più volte sullo stesso paziente
- ✗ per prelevare soluzioni o medicinali da flaconi multidose
- ✗ per somministrare medicinali dalla stessa siringa a più pazienti anche se l'ago o la cannula vengono cambiati




Fiale o ampole di medicinali iniettabili devono essere monodose quando possibile.

- ✗ non somministrare *mai* medicinali da una fiala monodose a **più di un paziente**
- MA**
- ✓ gettare in sicurezza (*sharp safe*) eventuali rimanenze



In caso di uso indispensabile di fiale o di ampole di medicinali multidose, assicurarsi che l'ago, la cannula e la siringa utilizzati per accedervi siano rigorosamente sterili.

- ✗ non tenere mai ampole o fiale di medicinali multidose nelle zone dove vengono curati i pazienti
- ✗ non lasciare mai dispositivi di prelievo sui flaconi, ma eliminarli subito e in sicurezza
- MA**
- ✓ eliminare in sicurezza le fiale o le ampole qualora la loro sterilità non sia garantita



Usare un flacone o una sacca di liquido di infusione ed il set per la sua somministrazione per un solo paziente ed eliminarlo subito dopo l'uso.

- ✗ non utilizzare *mai* flaconi, bottiglie o sacche di soluzioni endovenose **come fonte comune** per più pazienti
- MA**
- ✓ gli aghi o le cannule sono da considerare contaminati una volta che sono stati connessi al flacone di infusione intravenosa del paziente o al set per la somministrazione intravenosa